



ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.....

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ คือ

๑. ชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทไขสันหลัง (Spinal Cord Stimulation) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดเรื้อรังอันเกี่ยวเนื่องมาจากระบบประสาท (Neuropathic Pain) ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายหรือบรรเทาลงได้ด้วยการรักษาด้วยยาหรือวิธีการอื่นโดยการผ่าตัดฝังอุปกรณ์กระตุ้นไขสันหลังไว้ภายในร่างกายผู้ป่วย

๒. ชุดเครื่องมือช่วยนำการใส่ท่อช่วยหายใจ ระบบวิดิทัศน์แบบจอแยก (Video Laryngoscope and Video Intubation Stylets) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ทางช่องปากและช่องจมูก และช่วยตรวจสอบตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ ระบบวิดิทัศน์แบบจอแยก (Video Laryngoscope and Video Intubation Stylets)

๓. เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบการจี้และตัดแบบแอดวานซ์ไบโพลาร์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องมือที่ใช้จี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดชนิดเปิดทั่วไปและผ่าตัดผ่านกล้อง ตัวเครื่องสามารถใช้ได้กับหัวจี้ตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Ultrasonic) และหัวจี้ตัดด้วยแอดวานซ์ไบโพลาร์ (Advance Bipolar) โดยการตัดและจี้ห้ามเลือดของเส้นเลือด หรือการตัด จับ และเลาะแยกเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ เมื่อต้องการควบคุม การหยุดห้ามเลือด และช่วยลดการกระจายความร้อน ไม่ให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียง

๔. ชุดกล้องส่องตรวจปอดและทางเดินหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ (Disposable Bronchoscope with Monitor) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อส่องตรวจปอดและทางเดินหายใจแบบใช้ครั้งเดียว โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ ในการแสดงภาพ บันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหว

๕. เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Transmission Monitor) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อเพื่อตรวจสอบผลกระทบของยาหย่อนกล้ามเนื้อ ต่อผู้ป่วยในห้องผ่าตัด ห้องพักรับฟื้น หรือห้องดูแลผู้ป่วย ที่อยู่ในภาวะวิกฤต

๖. เครื่องล้างและฆ่าเชื้อเครื่องมือแบบอัตโนมัติ (Automatic Washer and Disinfector) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการนำกลับมาใช้งานใหม่ เครื่องมือผ่าตัดที่มีลักษณะแข็ง เช่น คีม กรรไกร ถาดขามรูปไต อุปกรณ์ดมยาสลบ เครื่องแก้ว วัสดุพลาสติกยางและอื่นๆที่ใช้ในโรงพยาบาล

๗. เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมวัดค่าสัญญาณชีพขั้นสูงและสามารถรองรับการวัดคุณภาพการกดหน้าอกที่หน้าจอภาพได้ (Defibrillator with vital signs with advance monitor Support quality of chest compressions) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าและสามารถรองรับภาควัดต่างๆ รวมถึงเพิ่มภาควัดต่างๆ ได้ภายในอนาคต พร้อมทั้งแสดงคุณภาพของการกดหน้าอก

สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลตามผนวก ก.ที่แนบ

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณาข้อมูล เพื่อนำมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ของกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ให้ส่งข้อมูลภายใน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ ๓๑๕ พงษ์ญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำมามอบให้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย


๔. หากผู้เสนอมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐-๒๓๕๔-๗๗๖๘

๕. คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือของรายหนึ่ง รายใดมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

๖. กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

พันเอก

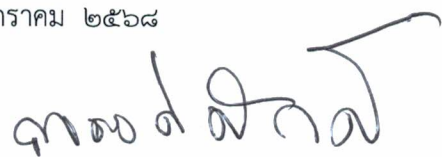

(ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภทรกุล)

ผู้อำนวยการกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


ผนวก ก.

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ชื่อสิ่งอุปกรณ์ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)
๒. หน่วยนับ
๓. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ (ให้ทราบว่าสิ่งอุปกรณ์เป็นอะไรมีรูปร่างและขนาดอย่างไร)
๔. คุณลักษณะในการใช้งาน (ใช้ทำอะไร ทำด้วยอะไร ชัดความสามารถในการใช้งาน)
๕. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค (ถ้ามี)
๖. การบรรจุหีบห่อ
๗. ข้อกำหนดอื่น (มีเอกสารคู่มือในการใช้งาน คู่มือในการซ่อมบำรุง มีมาตรฐานสากล)
๘. วิธีการตรวจสอบ (กำหนดไว้เพื่อให้กรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบให้ตรงตามกำหนด)
๙. Catalogue หรือ Leaflet
๑๐. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์
๑๑. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี)
๑๒. สำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์จาก อย. (เครื่องมือแพทย์) (ถ้ามี)
๑๓. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ โทรสารที่ติดต่อได้

ตรวจถูกต้อง

พันเอก

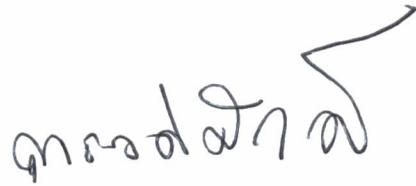

(ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภักตร์กุล)

ผู้อำนวยการกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า