

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 155/61 (พบ.)

หมายเลข คผ. 6515 - M - 61 - S - 0056

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผลแบบเส้นใยถักเคลือบด้วยสารต้านเชื้อแบคทีเรีย  
ชนิดละลายได้  
( Braided Synthetic Absorbable Antibacterial Suture )

หน่วยนับ ของ

#### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเย็บแผล และผูกมัดเส้นเลือด หรือในงานศัลยกรรมทุกประเภทที่  
ต้องการใช้วัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้

#### 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายได้ มีส่วนผสมของ Glycolide และ L-lactide

1.2.2 มีสารเคลือบผิว Suture ด้วย Polyglactin 370 และ Calcium Stearate

1.2.3 เคลือบด้วยสาร Antiseptic ต้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็น Broad-Spectrum Antibacterial Agent  
เป็นฟอร์มบิรียูทิกซ์ของ Triclosan ต่อด้าน Bacteria Colonization ที่ก่อให้เกิด SSI ได้อย่างน้อย  
4 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, Methicillin  
Resistant S. Aureus และ Methicillin Resistant S. Epidermidis

1.2.4 การรักษาแรงดึงของ Suture (Tensile Strength) ใน 28 วัน แรงดึงของ Suture คงเหลือ 25 %

1.2.5 สามารถละลายได้ (Absorbable)

#### 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นวัสดุเย็บแผล (Suture) ชนิดสังเคราะห์แบบถัก (Braided) เคลือบด้วยสารต้านเชื้อแบคทีเรีย

1.3.2 บรรจุในซอง ของละ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

#### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาด และความยาวของวัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผลแบบเส้นใยถักเคลือบด้วยสารต้านเชื้อแบคทีเรีย  
ชนิดละลายได้ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

/คณะกรรมการ...

28 ส.ค. 2561




ชื่อสิ่งอุปกรณ์


วัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผลแบบเส้นใยถักเคลือบด้วยสารต้านเชื้อแบคทีเรีย  
ชนิดละลายได้

( Braided Synthetic Absorbable Antibacterial Suture )


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

( ปุญชทร ทิพยวงษ์ )

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ


( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.ท.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


( สถาพร มั่นมา )

28 ส.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

( ทักชิน เจียมทอง )


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ


( ปกจิจ์ แสงสว่าง )

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

( ปราโมทย์ จันทิมพิ )

18 เม.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวค.พบ.  
ที่ คท 0446.13/..........ลง.19.10.61

  
( จิตพร สมสารธรรม )  
เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.ร.6  
...../...../.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 154/61 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 61 - S - 0055

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผลแบบเส้นใยถัก ชนิดละลายได้  
( Braided Synthetic Absorbable Suture )

หน่วยนับ ซอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเย็บแผล และผูกมัดเส้นเลือด หรือในงานศัลยกรรมทุกประเภทที่ต้องการใช้วัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายได้ มีส่วนผสมของ Glycolide และ L-lactide

1.2.2 มีสารเคลือบผิว Suture ด้วย Polyglactin 370 และ Calcium Stearate

1.2.3 การรักษาแรงดึงของ Suture (Tensile Strength) ใน 28 วัน แรงดึงของ Suture คงเหลือ 25 %

1.2.4 สามารถละลายได้ (Absorbable)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นวัสดุเย็บแผล (Suture) ชนิดสังเคราะห์แบบถัก (Braided)

1.3.2 บรรจุในซอง ซองละ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาด และความยาวของวัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผลแบบเส้นใยถัก ชนิดละลายได้ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

วัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผลแบบเส้นใยถัก ชนิดละลายได้  
( Braided Synthetic Absorbable Suture )

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ  
( ปุณชทร ทิพวงษ์ )


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )


พ.ท.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
( สถาพร มั่นมา )

28 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.


พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ  
( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( ปกิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ  
( ปราโมทย์ จันทมิฬ )

18 เม.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวท.ทบ.  
ที่ กท 0446.13/..... ลง 14 เม.ย. 61

สำเนาถูกต้อง  
พ.อ.  
  
(ธราวุฒิ เกษมสายสุวรรณ)  
เจ้าหน้าทีพัสดุ รพ.ร.ร.๖

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 218/46 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 62 - S - 1542

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยวไม่ละลาย  
( Monofilament Non-Absorbable Suture )

หน่วยนับ ซอง/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เย็บแผลและผูกเส้นเลือด, เนื้อเยื่อในการผ่าตัดทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ทำจากสารสังเคราะห์ไนลอน (Nylon) หรือโพลีเอไมด์ (Polyamide) หรือโพลิโพรไพลีน (Polypropylene) หรือสารสังเคราะห์อื่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นวัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยว (Monofilament) ที่ไม่ละลาย (Non-Absorbable)

1.3.2 ขนาดของเส้น ความยาว และขนาดของเข็มผู้ใช้งานจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุซองละ 1 เส้น

1.3.4 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ.





/คณะกรรมการ...


18 เมย 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดียวไม่ละลาย  
( Monofilament Non-Absorbable Suture )

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

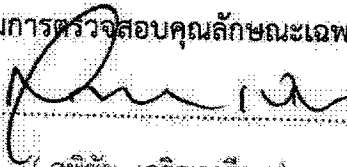
พ.อ.  ..... ผอ.กอง ทบ./ประธานกรรมการ  
( ปุณฺชทร ทิพยวงษ์ )


พ.อ.หญิง  ..... ผอ.กอง ทบ./กรรมการ  
( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )


พ.ต.หญิง  ..... พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
( น้ำฝน วรรณศรีจันทร์ )

18 มิ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.


พล.ต.  ..... ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ  
( สุพิชัย เจริญวารีกุล )

พ.อ.  ..... ผอ.กอง ทบ./กรรมการ  
( ปกกิจ แสงสว่าง )

พ.อ.  ..... นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ  
( ปราโมทย์ จันทมิฬ )

๕ 1 พ.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีอนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.  
ที่ กท.0446.13/..... 544 ลง. 13พ.ค.62

สำเนาถูกต้อง   
พ.อ. (สราวุธ เกษมสายสุวรรณ)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.ร.๖  
...../...../.....