

①, ②, ③, ④

หน้า 1 ใน 2 หน้า

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 384/49 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2813

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ตัด จับ เลาะแยกชิ้นเนื้อในการผ่าตัดด้วยกล้อง
(Endoscopic Instrument)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตัด จับ เลาะ จี้เนื้อเยื่อหรือตัดเก็บชิ้นเนื้อด้วยไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจทางพยาธิของอวัยวะภายในการผ่าตัดด้วยกล้อง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ปลายของเครื่องมือแบบต่างๆ ผลิตจากโลหะปลอดสนิม

1.2.2 ก้านหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าทำลายเนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงและเพื่อป้องกันการสะท้อนของแสงภายใต้กล้อง

1.2.3 สามารถหมุนปรับได้ 360 องศา หรือชนิดหมุนไม่ได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ปลายปากมีหลายแบบให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 มีหลายขนาดและความยาวให้เลือก จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ.

23 ก.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

อุปกรณ์ตัด จับ เลาะแยกชิ้นเนื้อในการผ่าตัดด้วยกล้อง
(Endoscopic Instrument)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ท.หญิง.....นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.6/

(เพ็ญสุภา พิมพ์จันทร์) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

23 ก.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพิ)

- 3 ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/1163 ลง 11.๑.๖3

พ.ต.หญิง พุคณีย์ พงษ์ชนะ

(บุรฉัตร พงษ์ชนะ)

พยาบาลช่วยหน.ห้องผ่าตัดศัลยกรรม

(5-2)

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 385/49 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 5775

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์เจาะผนังหน้าท้องสำหรับการผ่าตัดด้วยกล้องแบบใช้ครั้งเดียว
(Disposable Troca)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เจาะให้เป็นทางหรือช่องสำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้อง (Endoscopic Instrument)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีลักษณะเป็น One Way Valve เพื่อลดการสูญเสียแก๊ส

1.2.2 มีลิ้นปิด-เปิด เป็นแผ่นยางมีรูตรงกลางทำให้แนบกับเครื่องมือ หรือสามารถยึดจับขณะเครื่องมือที่ผ่านเข้าออกได้

1.2.3 มีอุปกรณ์ Safety เพื่อความปลอดภัยในขณะใช้งาน

1.2.4 สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ลดขนาดช่อง Trocar โดยไม่ทำให้เกิดลมรั่ว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เจาะผนังหน้าท้อง โดยสามารถประกอบเข้ากับตัวลดขนาดช่อง Trocar ซึ่งมีแบบให้เลือก ดังนี้

1.3.1 อุปกรณ์เจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด , แบบไม่มีใบมีด หรืออื่นๆ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 อุปกรณ์เจาะหน้าท้องมีหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและหลายความยาวให้เลือก ผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ตัวลดขนาดช่อง Trocar มีหลายแบบให้เลือก ขนาดจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.5 ชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

อุปกรณ์เจาะผนังหน้าต่างสำหรับการผ่าตัดด้วยกล้องแบบใช้ครั้งเดียว
(Disposable Troca)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญขจร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

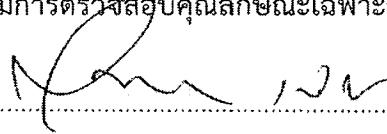
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ..........หน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สามารถ ปานเดือน)

19 ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกกิจ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพิง)

27 ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/...1227 ลง 16 ก.ย. 63



คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 312/49 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 63 - S - 5761

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงใส่ชิ้นเนื้อในการผ่าตัดด้วยกล้อง
(Endobag Specimen Retriveval)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับใส่ชิ้นเนื้อหรือเนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 เป็นถุงที่ทำมาจากพลาสติกที่มีความเหนียวและทนทานต่อการฉีกขาด
 - 1.2.2 ขนาดของถุงมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว และความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
 - 1.2.3 ตัวถุงบรรจุอยู่ในท่อพลาสติกแข็ง โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 mm ขึ้นไป
 - 1.2.4 ขอบปากถุงสามารถคลี่ออกได้ง่ายและสะดวกต่อการจับ
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
 - 1.3.1 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
 - 1.3.2 บรรจุช่องละ 1 ชิ้น เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาถือ และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....หน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สามารถ ปานเถื่อน)

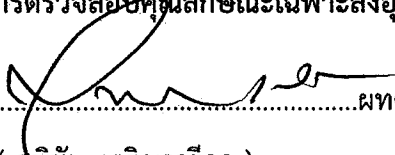
- 4 ก.ย. 2563

/คณะกรรมการ...


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ถุงใส่ชิ้นเนื้อในการผ่าตัดด้วยกล้อง
(Endobag Specimen Retriveval)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สฤษชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

14 ก.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुวัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวท.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 1385 ลง 25 ก.ย. 63

พ.ต.หญิง  พง.บ.

(บุรฉัตร พงษ์ธนะ)

พยาบาลช่วยหน.ห้องผ่าตัดศัลยกรรม