

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 035/49

หมายเลข คจ. 6530 - M - 62 - P - **1 1 3 9**

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ ด้วยระบบไฮดรอลิค
(Hydraulic Stretcher).

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท้องผ่าตัดห้องรอฟื้นและหอผู้ป่วยวิกฤต
ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค .

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวเตียงทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคควบคุมโดยใช้เท้าเหยียบ มีแกนไฮดรอลิคเป็นแบบแกนคู่

1.2.2 สามารถปรับระดับและท่าต่างๆ ของเตียงได้ ดังนี้

1.2.2.1 ปรับระดับความสูงของเตียงขึ้นสูงสุดได้ 90 เซนติเมตรหรือสูงกว่าและปรับระดับให้ต่ำลง
มาได้ถึง 65 เซนติเมตรหรือต่ำกว่า

1.2.2.2 ปรับท่าศีรษะต่ำได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา.

1.2.2.3 ปรับท่าศีรษะสูงได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา

1.2.2.4 ปรับพาดขาสูงได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา .

1.2.2.5 ปรับพนักพิงสูงได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา โดยใช้ระบบแก๊สสปริง

1.2.3 ล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร มีระบบเบรกติดตั้งทั้ง 4 ล้อ.สามารถล็อกได้
พร้อมกันเมื่อกดล็อกที่ล้อใดล้อหนึ่ง

1.2.4 มียางกันกระแทกที่มุมทั้ง 4 จุด รอบเตียง .

1.2.5 พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ทำด้วยเหล็กเคลือบสีหรือเหล็กเคลือบสาร Galvanized หรือโลหะ
ชนิดอื่นที่ดีกว่า

1.2.6 สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 170 กก. .

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับด้วยระบบไฮดรอลิค แบบใช้เท้าเหยียบขนาดกว้าง x ยาว
ไม่น้อยกว่า 80 x 200 เซนติเมตร .

1.3.2 มีแป้นเหยียบสำหรับปรับระดับและท่าต่างๆ ของเตียงอยู่ที่ด้านข้างทั้ง 2 ด้านของเตียง

1.3.3 มีราวกันเตียง 2 อัน ความยาวตลอดเตียง เป็นแบบเหล็กเคลือบสีหรือโลหะชนิดอื่นที่ดีกว่า
ซึ่งสามารถพับเก็บได้ .

1.3.4 มีที่เสียบเสาน้ำเกลือได้ไม่น้อยกว่า 4 จุดรอบเตียง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

พ.อ.

18 เม.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดรับระดับได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก
(Hydraulic Stretcher)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีที่รอนนอนขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว.
- 3.2 ที่ฐานล้อได้เตียงมีที่วางถังออกซิเจนได้อย่างน้อย 1 ถัง.
- 3.3 มีฐานครอบปิดที่ฐานเตียงเพื่อป้องกันฝุ่นทำจากพลาสติก.
- 3.4 มีเสาแขวนน้ำเกลือทำด้วยสแตนเลส ชนิด 2 แขน, 4 แขน อย่างละ 1 อัน.
- 3.5 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.6 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.7 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ.





18 เม.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ ด้วยระบบไฮดรอลิค
(Hydraulic Stretcher)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

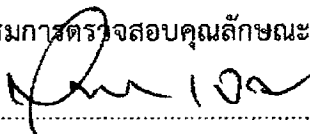
พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชพร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.หญิง..........หน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สิริวรรณ สมจินตนา)

18 เม.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.


พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นบก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทิมพ)

1 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

น.อ.  11 ธันวาคม
(อรรถพร 11 ธันวาคม)

