

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พ. ที่ 019/63

หมายเลข คณ. 6525 - M - 63 - T - 0864

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายต่อป้องกันการไหลย้อนกลับของสารทึบรังสี
(Double Check Valve Patient Line)

หน่วยนับ ชิ้น, ห่อ, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นสายต่อสำหรับต่อกับกระบอกฉีดยา หรือถุงบรรจุสารทึบรังสีของเครื่องฉีดสารทึบรังสีอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของสารทึบรังสี ในการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography Scan)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายต่อทำด้วยพลาสติก หรือวัสดุที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 สามารถทนแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 PSI

1.2.3 ส่วนปลายด้านที่ต่อเข้ากับกระบอกฉีดยา หรือถุงบรรจุสารทึบรังสี จะมีวาล์วไม่น้อยกว่า 2 ชั้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อน จากการไหลย้อนกลับของสารทึบรังสีและเชื้อโรค

1.2.4 มีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นสายต่อ ปลายสายด้านที่มีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับของสารทึบรังสี และเชื้อโรค ต่อกับกระบอกฉีดยาหรือถุงบรรจุสารทึบรังสี ปลายสายอีกด้านต่อกับเข็มหรือสายที่เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 จำนวน และความยาว จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

สายต่อชนิดป้องกันการไหลย้อนกลับของสารที่บรรจุสี

(Double Check Valve Patient Line)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺณชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.หญิง.....หน.รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ปราณต์จรัส วัฒนะสกุลรัตน์)

- 7 กพ 2563

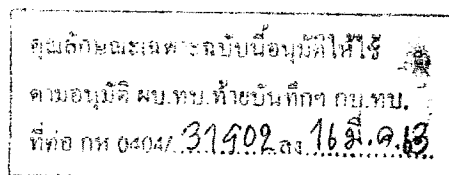

ตรวจถูกต้อง

พ.ต.

(ชูชีพ จันทา)

นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.๖