

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 048/51

หมายเลข คณ. 6530 - M - 62 - P - 1567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดแผ่นทดสอบระบบการทำงานของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบสุญญากาศ
(Bowie-Dick Test Pack for Pre- Vacuum Steam Sterilizer)

หน่วยนับ ชุด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพระบบการทำงานของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบสุญญากาศ (Pre-Vacuum) ก่อนการใช้งานในแต่ละวัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถทดสอบประสิทธิภาพ การแทรกซึมของไอน้ำ การรั่วไหลของอากาศ และการไล่อากาศออกจากภายในเครื่อง ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 132 องศาเซลเซียส ในเวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที

1.2.2 อ่านผลการทดสอบโดยคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงสีของสารเคมีที่เคลือบอยู่บนชุดแผ่นทดสอบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสีจะต้องสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแผ่นทดสอบทางเคมี บรรจุเป็นชุดสำเร็จรูป

1.3.2 มีวันหมดอายุการใช้งานกำกับไว้ที่ชุดแผ่นทดสอบและที่ข้างกล่อง

1.3.3 มีพื้นที่ว่างให้บันทึกข้อมูลหลังการทดสอบ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ.



/คณะกรรมการ...

24 มิ.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ชุดแผ่นทดสอบระบบการทำงานของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบสุญญากาศ
(Bowie-Dick Test Pack for Pre- Vacuum Steam Sterilizer)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.หญิง ทน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สิริวรรณ สมจินตนา)

24 มี.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)


พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ. นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพ)

- 5 ก.ค. 2562

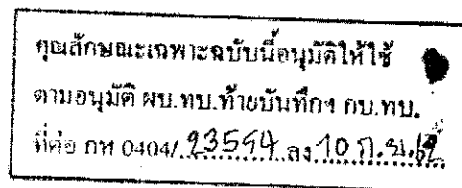

สำเนาถูกต้อง

.....

(พลยุทธ์ ทศนักรข)

ประจำ ผวภ.รพ.รร.๖